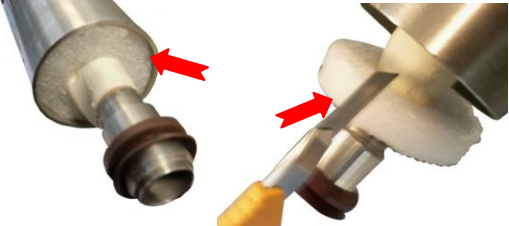
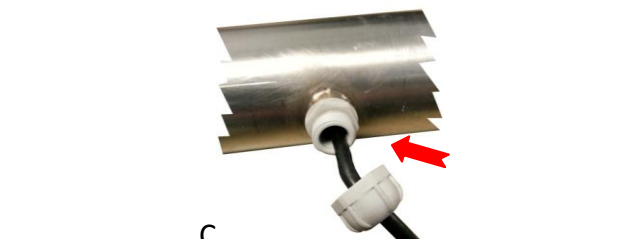
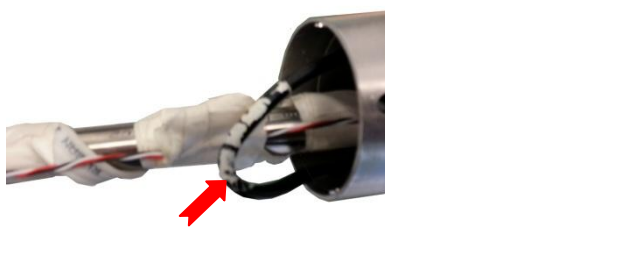


	CONDUIT RST 2M	Ref :121116_JPN_modif_RST2M
	Modification de la longueur chauffée de 2m à 1m.	Emetteur : JPN
		Date : 16/11/2012

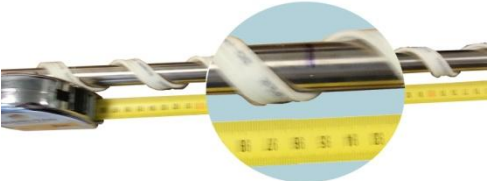
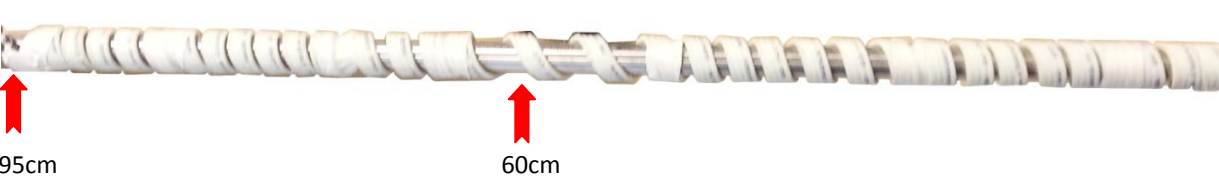
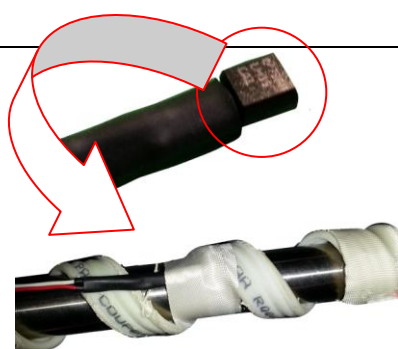
PROCEDURE

	Matériel et outillage nécessaire • 1 tournevis • 1 clé de 8 • 1 cutter • 1 mètre • 1 marqueur indélébile • Ruban adhésif isolant en tissu de verre Réf. 3M Scotch®27 larg. : 3/4" • Manchon en mousse de caoutchouc isolante standard. Insul-tube® 22-9 Longueur 1m Ø int. 22 mm Epaisseur 9 mm
	Déposer l'embout d'adaptation de tête fixé par 3 vis pour accéder aux vis de fixation du conduit intérieur sur le fourreau.
	Déposer les 4 vis TH (clé de 8) de fixation.
	Déposer la cale de mousse en la tirant avec une pince puis en la fendant d'un côté avec un cutter.

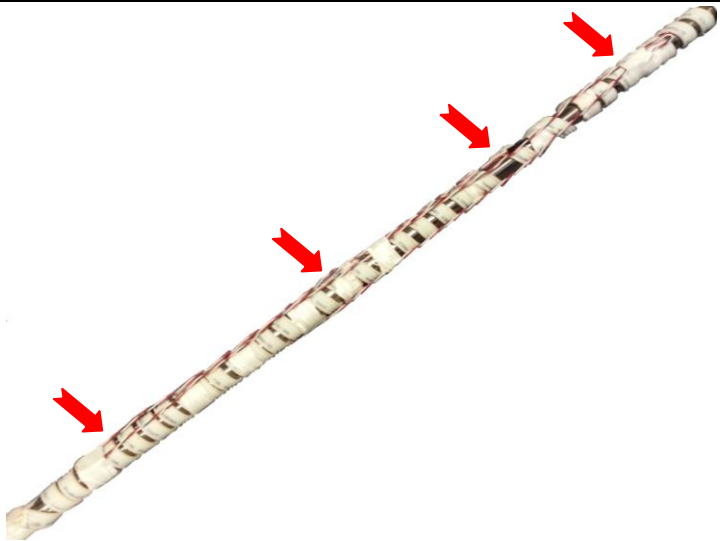
	CONDUIT RST 2M	Ref :121116_JPN_modif_RST2M
	Modification de la longueur chauffée de 2m à 1m.	Emetteur : JPN
		Date : 16/11/2012

	Fixer une « aiguille » suffisamment longue (3m) sur les connecteurs pour faciliter le remontage.
 C	Dévisser complètement le presse étoupe du câble de liaison des capteurs humidité et température ambiante pour le libérer.
	Sortir le conduit intérieur du fourreau jusqu'à apercevoir le ruban adhésif fixant le câble noir de liaison des capteurs humidité et température au conduit.
	Couper le ruban adhésif pour libérer le câble et sortir le conduit intérieur du fourreau jusqu'au prochain ruban adhésif fixant le câble noir de liaison des capteurs humidité et température au conduit. Libérer le câble.
 Procéder ainsi jusqu'à pouvoir sortir entièrement le conduit intérieur du fourreau.	
	Attention : Ne jamais couper le ruban adhésif fixant les divers éléments à l'extrémité basse du conduit.
	Libérer la sonde de régulation de température en coupant le ruban adhésif la fixant jusqu'au bas du conduit.

	CONDUIT RST 2M	Ref :121116_JPN_modif_RST2M
	Modification de la longueur chauffée de 2m à 1m.	Emetteur : JPN
		Date : 16/11/2012

	Libérer le cordon chauffant en coupant le ruban adhésif la fixant jusqu'au bas du conduit.
	Marquer un repère sur le conduit à 50 cm du haut de ce dernier.
	Marquer un repère sur le conduit à 95 cm du bas de ce dernier.
	Marquer un repère sur le conduit à 60 cm du bas de ce dernier.
	
Répartir le cordon chauffant entre le repère 95cm (position de la sécurité thermique) et le bas du conduit en laissant 2 spires plus espacées à proximité du repère 60 cm (nouvelle position de la sonde de régulation) en s'assurant d'un bon contact des spires avec le conduit. Fixer le cordon chauffant sur le conduit avec du ruban adhésif en s'assurant d'un bon contact des spires et particulièrement de la sécurité thermique avec le conduit.	
	Fixer la sonde température, face plane en contact sur le tube.

	CONDUIT RST 2M	Ref :121116_JPN_modif_RST2M
	Modification de la longueur chauffée de 2m à 1m.	Emetteur : JPN
		Date : 16/11/2012

	Enrouler le surplus de câble de la sonde température sur lui-même et le fixer avec de l'adhésif.
	Isoler la partie non chauffée du conduit avec le manchon de mousse isolante.
	Réintroduire le conduit dans le fourreau en maintenant la boucle du câble capteurs météo hors du fourreau
	Fixer le câble capteurs météo a 50 cm du haut du conduit.
	Finir d'introduire le conduit. Tirer au maximum le câble capteurs météo du presse étoupe. Fixer le presse étoupe

	CONDUIT RST 2M	Ref :121116_JPN_modif_RST2M
	Modification de la longueur chauffée de 2m à 1m.	Emetteur : JPN
		Date : 16/11/2012

	Remettre les 4 vis de fixation
	Remettre l'embout d'adaptation
	Remettre la cale en mousse

GARANTIE

Environnement-sa s'engage à maintenir ses conditions de garantie sur cet élément si sa modification est faite dans le respect de cette procédure.